




▶ VNITŘNÍ MIKROMETRY

do 200 mm

TORQARD

Základní charakteristika:

- ▶ přesnost: výrobní norma
- ▶ měřící doteky z tvrdokovu
- ▶ s řehačkou v bubínku pro konstantní měřící sílu
- ▶ nastavovací kroužky / měřka je součástí měřidla u velikosti 5-30 mm, 25-50 mm a sady 5-100 mm. U ostatních velikostí je nutno objednat zvlášť.

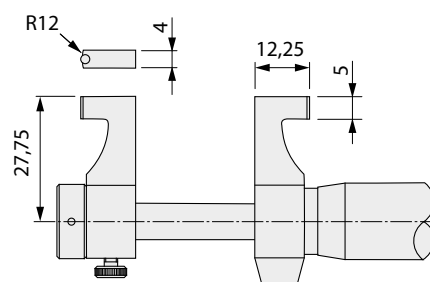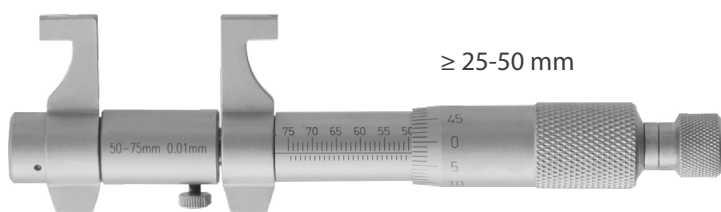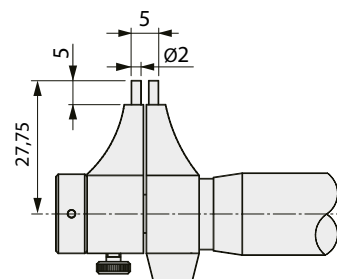

Objednáací číslo	Měřicí rozsah (mm)	Odečítání (mm)	Přesnost (mm)	Nastavovací kroužek / měřka (mm)	Standardní položka
4160-A-030	Ø 5 - 30	0,01	0,010	Ø 5	<input checked="" type="checkbox"/>
4160-A-050	Ø 25 - 50	0,01	0,010	Ø 25	<input checked="" type="checkbox"/>
4160-A-075	Ø 50 - 75	0,01	0,012	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4160-A-100	Ø 75 - 100	0,01	0,014	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4160-A-125	Ø 100 - 125	0,01	0,015	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4160-A-150	Ø 125 - 150	0,01	0,015	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4160-A-175	Ø 150 - 175	0,01	0,015	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4160-A-200	Ø 175 - 200	0,01	0,015	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4160-A-S-005-100	Ø 5 - 100	0,01	0,014	Ø 5 / Ø 25 / 75	<input checked="" type="checkbox"/>

KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednáací číslo **-KP** (např. 4160-A-030-KP)





▶ VNITŘNÍ MIKROMETRY

DIGITÁLNÍ - do 100 mm

TORQARD

Základní charakteristika:

- ▶ přesnost: výrobní norma
- ▶ měřící doteky z tvrdokovu
- ▶ funkce: ON/OFF - SET - UNIT (mm/inc) - ABS/INC
- ▶ s řehačkou v bubínku pro konstantní měřicí sílu
- ▶ nastavovací kroužky / měřka je součástí měřidla u velikosti 5-30 mm, 25-50 mm U ostatních velikostí je nutno objednat zvlášť.

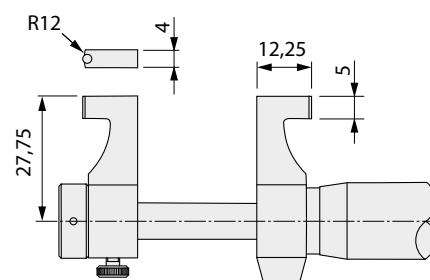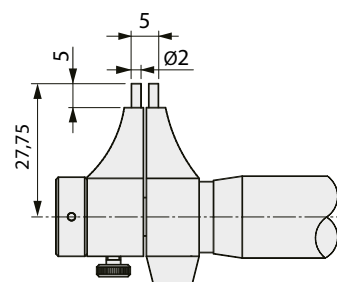

Objednací číslo	Měřicí rozsah (mm)	Odečítání (mm)	Přesnost (mm)	Nastavovací kroužek (mm)	Standardní položka
4160-D-030	Ø 5 - 30	0,001	0,005	Ø 5	<input checked="" type="checkbox"/>
4160-D-050	Ø 25 - 50	0,001	0,006	Ø 25	<input checked="" type="checkbox"/>
4160-D-075	Ø 50 - 75	0,001	0,007	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4160-D-100	Ø 75 - 100	0,001	0,008	-	<input checked="" type="checkbox"/>

KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednáč. číslo **-KP** (např. 4160-D-030-**KP**)